MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PELIGRO – El mal uso de los equipos eléctricos puede causar electrocución quemaduras, fuego y otros PELIGROS

Deben siempre ser tenidas en cuenta las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las que se indican a continuación.

LEER ESTAS ADVERTENCIAS ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO

- Comprobar que la tensión de alimentación, coincide con la tensión de red disponible.
- Conexión a la RED de alimentación: Conectar el equipo a una base de alimentación (Tomacorriente) que tenga conexión de tierra.
- No colocar el equipo en un sitio donde pueda caer líquido. Si el equipo llega a mojarse, desconectarlo antes de tocarlo.
- Utilizar el equipo sólo para los fines descritos en las instrucciones de uso.
- No utilizar accesorios que no sean suministrados o recomendados por el fabricante.
- No utilizar el equipo si no trabaja correctamente, o si ha sufrido cualquier daño.
  Ejemplos:
  - Daños en los cables flexibles de alimentación o en su toma.
  - Daños causados por la caída del equipo.
  - Daños causados por la caída del equipo en agua o salpicaduras de agua sobre él.
  - Cualquier tipo de mensaje de error o alarma en el equipo, pérdidas de líquidos o tuberías dañadas.
  - Cualquier otro tipo de anomalía.
- No permitir que el equipo o su cable flexible de alimentación entren en contacto con superficies que están demasiado calientes al tacto.
- No colocar nada en la parte superior del equipo.
- No dejar caer ni colocar nada en ninguna de las aberturas del equipo, o sobre cualquier manguera o acoplamiento.
- No utilizar el equipo en el exterior.
- La base de alimentación (Tomacorriente) donde se conecta la fuente de alimentación del equipo debe estar accesible en todo momento para permitir el encendido y apagado del mismo en cualquier situación.
- **Siempre utilizar guantes.**

INSTALACION

1. Desembalaje

Cuidadosamente desembale y verifique que se encuentren los siguientes elementos:
. REF EQ 03XX o 04XX Analizador Diestro 103/103+.
. REF IN 0201 Kit de Soluciones Calibradoras
. REF IN 0300 Diluyente de orina ISE.
. REF IN 0600 Acondicionador de Sodio.
. REF RE 0803 Manual del usuario Diestro 103/103+.
. REF RE 0900 Fuente de alimentación 12V 1.5A.
. REF RE 0100 Tubería para bomba peristáltica.
. REF RE 0201 Capilar de toma de muestra.

2. Requerimientos de Instalación

2.1. Tensión de alimentación

100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
La tensión de alimentación y el tomacorriente deben cumplir con las reglamentaciones eléctricas locales.
Debe haber una conexión a tierra disponible para conectar la tierra del equipo.
La tensión de red debe estar libre de ruido y variaciones. Si es necesario, se recomienda instalar un estabilizador.

2.2. Condiciones ambientales de instalación

Verificar las condiciones ambientales de operación detalladas en la sección "Especificaciones Técnicas"

2.3. Lugar de instalación

Debe instalarse en un lugar nivelado, limpio, sin vibraciones, que permita al operador situarse delante del equipo sin ningún obstáculo, sin objetos que toquen los laterales del analizador y que soporte el peso del equipo.

Dimensiones

Alto: 260mm
Ancho: 250mm
Profundidad: 250mm
Peso: 7kg

El tomacorriente donde se enchufará la Fuente de Alimentación del Equipo debe tener fácil acceso para la conexión y desconexión en cualquier momento.

3. Conexión

Usar los cables y accesorios provistos con el equipo.
Si es necesario reemplazar alguno, usar repuestos provistos o recomendados por el fabricante.

3.1 Conectar el plug de la fuente de alimentación al receptáculo del analizador. **(*Fig. 1*)**

Aun no conecte la fuente de alimentación al tomacorriente

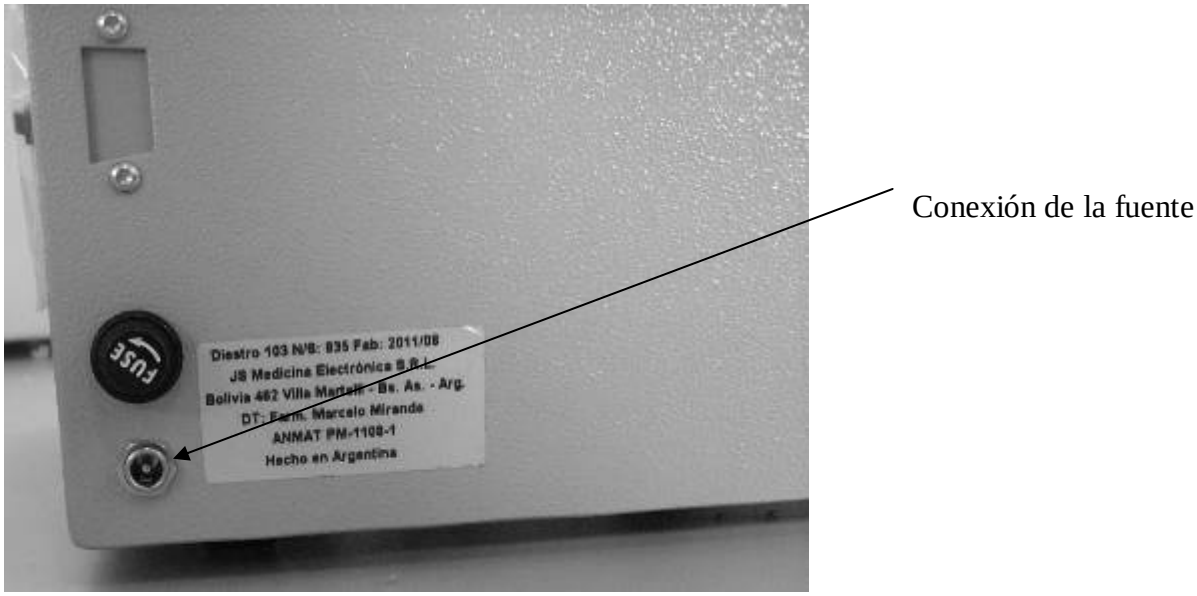
FUSE
Diestro 103 N/S: 835 Fab: 2011/08
JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 Villa Martelli - Bs. As. - Arg.
DT: Farm. Marcelo Miranda
ANMAT PM-1108-1
Hecho en Argentina
Conexión de la fuente

Fig. 1 Conexión de la fuente de alimentación

3.2 Si el equipo va conectado a una PC o impresora externa conecte el cable serie RS232. (solo modelo 103+)

Para la conexión serie con una PC usar un cable Null-Modem

3.3 Conectar el uchip del Kit de soluciones calibradoras **(*Fig. 2*)**

Fig. 2 Kit de soluciones calibradoras IN 0201

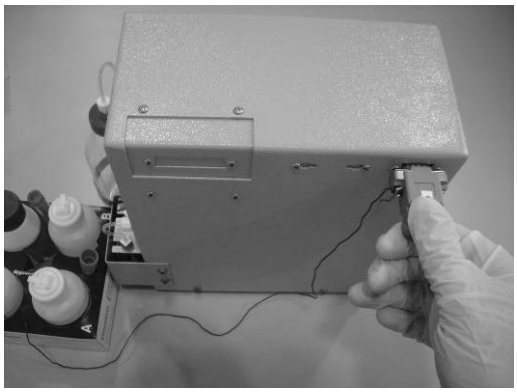

Fig. 3 Conexión de uchip

3.4 Conectar la tubería peristáltica

4.1 Retirar la tapa del cabezal peristáltico.

4.2 Remover uno de los acoples de la tubería peristáltica del soporte

4.3 Envolver el cabezal de la bomba peristáltica con al tubería, para que haga contacto con los rodillos del cabezal

4.4 Insertar el acople libre en el soporte.

4.5 Volver a colocar la tapa del cabezal peristáltico.

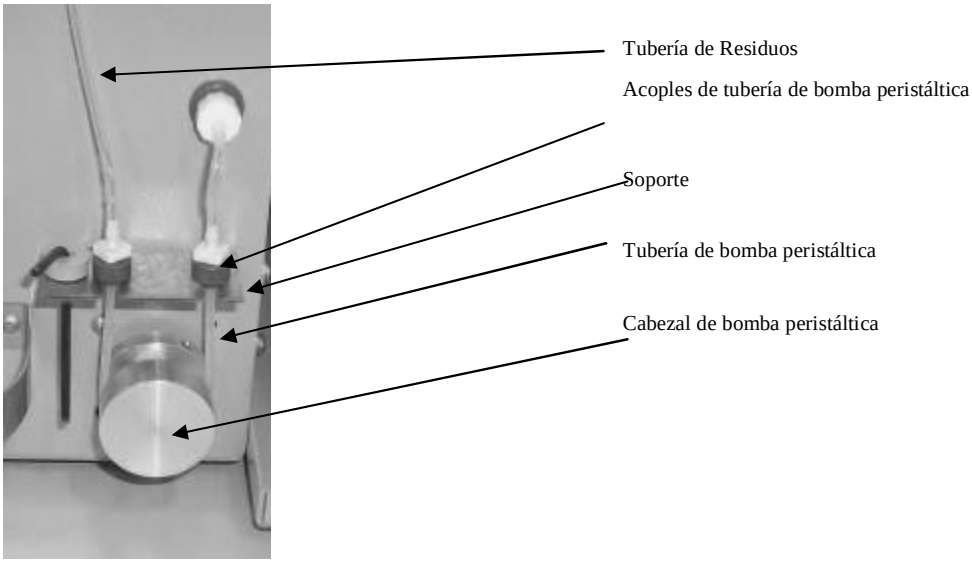

Bomba peristáltica

3.5 Conectar la fuente de alimentación a la red eléctrica.

3.6 Verificar la fecha y hora del analizador y efectuar una calibración de 2 puntos para poder comenzar a utilizar el equipo.